フロート引上げガイド取扱い説明書

液相部漏洩試験終了後、磁歪式液面変位計を引き上げる際、フロートが配管エッジに引っかかり引上げが困難なときに使用します。

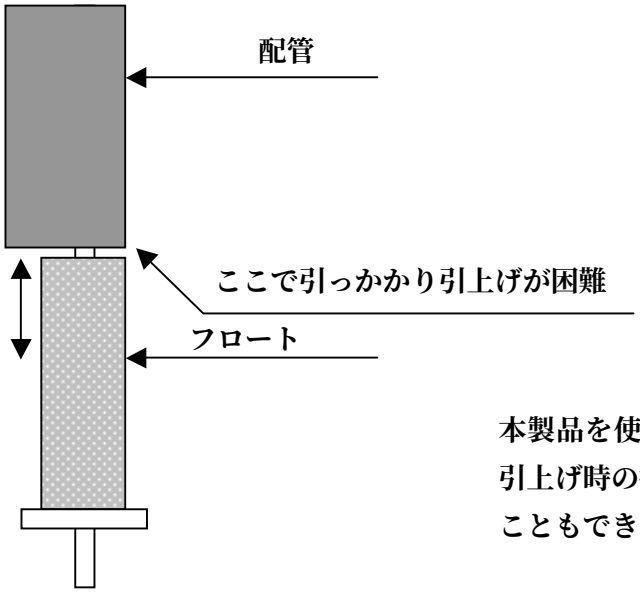

本製品を使用することによりフロートの引上げ時の衝撃から、フロートを保護することもできます。

引上げガイド取付方法

①笠部分からセンサーロッドに挿入

②パチンとはまったら落下させる。

③この状態でタンクから引き上げる。

④取外す。

注意事項

装着後は必ず取外してください。そのままにしますとフロートが沈んで試験できなくなります。

材質上、濃硫酸には漬けないでください。

大きな力を加えると破損する可能性があります。取付け時、取外し時注意してください。

無理をして引き上げた時、落下することがあります。慎重に扱ってください。

溶剤が手に付着し皮膚を傷める事ことがあります。溶剤使用時は十分注意してください。

材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK 樹脂)

耐薬品性:濃硫酸以外のすべての溶剤、薬品、油脂に使用できます。

耐衝撃性:引張強度９９０ｋｇ／ｃｍ^2（２３℃）　　耐熱樹脂の中では最も強靭な材質です。